



الى: السادة الراغبين بالمشاركة

م/ اعلان مناقصة عامة
(تجهيز مواد تعبئة وتغليف)

1. على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال بـ (الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء) ٧ ساعات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
2. متطلبات التأهيل المطلوبة: (جميع الراغبين بالمشاركة من ذوي الخبرة والاختصاص (شركات / مكاتب).
3. يمكن مقسي العطاء المهتمين بشراء وثائق المناقصة مراجعة جهة التعاقد لغرض شرائها ورقياً وبما كحق لهم شراءها (وثائق المناقصة) الكترونياً عبر المنصة الالكترونية .
4. يلتزم المنقص الفغز بالإحاطة بتكليم وصل (ورقي) او (الكتروني) صالغ من اذارة المنصة الالكترونية بويذ تسديده لاجور خدمات الاعلان والارشافة الالكترونية للعد عبر المنصة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠ يوماً) من تاريخ التليغ بالإحاطة وحسب التعليمات للعد.
5. يتم تسليم العطاءات من قبل مقسي العطاءات او مخلصيهم الرسميين وفق تخويل رسمي مصدق من كاتب عدل الى العنوان الآتي (مقر الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية بسامراء - التشرريفات - صندوق العطاءات) في الموعد المحدد في الجدول ائناه ولاتقبل العطاءات المتأخرة او التي يتم تسليمها بواسطة البريد الالكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقسي العطاءات او ممثلهم الراغبين بالحضور في (مقر الشركة في سامراء) في الزمان والتاريخ (الساعة ١٢ ظهراً من يوم تاريخ الفلق المحدد) واذ وافق يوم الفلق عطلة رسمية سيكون اليوم التالي هو اخر موعد لتقديم العطاءات.
6. يجب ان يتضمن العطاء الشروط والمستمسكات التالية: - (شهادة تأسيس الشركة او المكتب مصورة ملون، هوية عرقفة التجارة نافذة ، اصل مسالة ، ويقضل حسابات ختامية لآخر سنتين مالية ، هوية تصنوف تجارية ، الهوية الضريبية لمقدم العطاء) .
7. التأمينات الأولية: مبلغ مقطوع وكما مبين في ائناه على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة من مصرف عراقى معتمد ويكون نافذا لمدة ٩٠ يوماً من تاريخ الفلق ويستبدل لتكون كلفة حسن الاداء بنسبة (٥%) من مبلغ العقد على شكل خطاب ضمان بعد التليغ بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد.
8. كتابة عدم منافعة من الهيئة العامة للتشرريفات ويكون باسم الشركة او المكتب وأيس باسم الشخص.
9. شن وثائق المناقصة واجور خدمات المنصة الالكترونية الموحدة للإحالات والمنقصات وتكون غير قابل الرد .
10. على مقدم العطاء الذي سبق له الاشتراك في المناقصة قاعد اعلانه ان يقدم وصل الشراء المسبق لها مع وثائق العطاء للمنقصة المعد اعلانه وفي حالة تعديل استمر شراء هذه الوثائق فيحصل مقدم العطاء الفرق بين السعريين في حالة زيادة السعر ويرافق مع عطلة الوصلين الاول والثاني وتؤول شن الوثائق الى الخزينة العامة
11. فترة سريان العطاء (٩٠) يوم من تاريخ فلق العطاءات.
12. لشركتنا حق في تصحيح او تالفي أي نقص في الاعلان المنشور على ان يكون من خلال نفس الصحف ووسائل النشر المعتمدة في الاعلان .
13. الشركة غير ملزمة بقبول أو طأ العطاءات، ولها الحق في اختيار ما يناسبها ، ولها الحق ايضاً تجزئة الاحالة على اكثر من مهجز ولها الحق ايضاً في الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة وبأسباب مبررة وإعادة وصل شراء وثائق المناقصة نون تعويض مقسي العطاءات.
14. في حالة عدم التزام مقسي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية فقه سيتم استبعاد العطاء ، مما يتطلب مراعاة ذلك عند التقديم.
15. يحق لشركتنا شراء جزءا او كامل الكمية والاحالة على اكثر من مهجز .
16. الجهة التي لها صلاحية القبول النهائي للمادة هي مختبرات شركتنا حصراً .
17. لاجور لتقدير مفوض او (مخونه الرسمي) في اكثر من شركة او مكتب تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.
18. بهمل أي عطاء غير مستوفى للشروط والمواصفات الفنية والتعبئة المطلوبة.
19. تدعو الشركة كافة المشاركين لحضور اجراءات فتح العطاءات في الساعة الثالثة عشر ظهراً من يوم (الفلق المحدد).
20. كما تدعو شركتنا كافة المشاركين لحضور المؤتمر السنوي عقده في مقرها للاجابة على استفسارات المهجزين قبل اسبوع من موعد الفلق .
21. للمزيد من المعلومات وبمكتم الاطلاع على مواصفات المادة المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة زياره موقعنا الالكتروني (<https://sdi.industry.gov.iq>) وموقع وزارة الصناعة والمعادن الالكتروني (www.industry.gov.iq) .
22. على مقدم العطاء جذب ابراءة شمة تشمل تسديد اجور الكهرباء والهاتف الارضي .
23. يلتزم المهجز بتقديم شهادة منشأ مصدقة من السفارة العراقية في بلد المنشأ بالإضافة الى الفاتورة ووثائق التعبئة .
24. في حالة ورود عطاء غير جدي بما فيه تقديم تأمينات غير مصدقة يتم استبعاد مقدم العطاء وعدم التعامل معه لمدة (٦) ستة اشهر من الاشتراك بالمنقصات والطلبات المحللة .
25. في حال علم التجهيز خلال المدة المحددة سيتم فرض غرامة بنسبة (٢٥%) من مبلغ الاحالة

رقم المناقصة العامة	تاريخ الفلق	المدة المطلوبة	التكفة التخمينية/ دينار	التأمينات الأولية/ دينار	سعر وصل شراء المناقصة/ دينار
2026/SDI/p/203	2026/5/4	انابيب المنويوم للمراهم والكيرييمات قياس ١٥ غم انابيب المنويوم للمراهم والكيرييمات قياس ٢٥ غم	439,600,000	10,110,000	440,000

المختصين الكيمياءوي

محمد عبدالقادر مصطفي

المحول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٦/٤/١٦



احتياج المناقصة

وزارة الصناعة والمعادن
الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية – سامراء
القسم التجاري-المشتريات المحلية

تاريخ الغلق 2026/5/4

المناقصة العامة 203/م/2026/SDI/

ت	اسم المادة	التعبئة القربة والتعبئة (بروفات) مخلططات هندسية	الكمية / الوحدة/ انبوب	التكلفة التخمينية / المفرد/ دينار	التكلفة التخمينية دينار	السعر الكلي / دينار	تاريخ الغلق	فترة التجهيز
1	ثايبب المنيوم للتراهم والكريات قياس ١٥ عم	حسبا المواصفات القربة والمخططات الهندسية	2,800,000	80	224,000,000	439,600,000 دينار	4/5/2026	30-80 يوم
2	ثايبب المنيوم للتراهم والكريات قياس ٢٥ عم		2,200,000	98	215,600,000			

- المنشأ يجب ان يكون من شركات معتمدة وحسب المواصفة المذكورة وان تقدم الشهادة المطلوبة مع العرض الغتي وبخلافه يتم اعتبار العرض غير مطابق للمواصفات.
- يجب ان لا يقل (Shelf life) للمادة المجهزة عن ثلثي عمرها المعتمد صناعيا.
- العرض يجب ان يكون مطابقاً للمواصفات المستورية والتعبئة المطلوبة وسيتم اعتبار اي عرض لا يطابق المواصفات المطلوبة غير مطابق بغض النظر عن السعر.
- يحمل المجهز المتكفي في التجهيز كافة الاضرار التي تلحق بشركتنا بسبب عدم تنفيذ البرنامج الانتاجي الخاص بالوكيلين التسويقيين اسوة بعقود الصحة.

المهندس الكيماوي

محمد عبدالقادر مصطفى

المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٦/٤/ ١٦



الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء

القسم : التخطيط والمتابعة الشعبة : السيطرة على مواد التعبئة والتغليف العدد : التاريخ : ٢٠٢٦/٣/٢٥

السيد مدير التخطيط والمتابعة المحترم:

م/ مواصفات انابيب سعة ٢٥ غم

1. Aluminum tubes 22× 115 mm (25 g) cylindrical printed according designe of each tube.

internally lacquered for Skin Oint .& Creams (medical use) with orifice membrane & white cap with punctured thorn .

specifications

a. The tubes must contains gasket ring made of latex 7mm wide & should be fixed in side the tube approx 2mm (+1,-1 mm) from the tube end & should have a constant thickness of 0.02 – 0.025 mm.

b. The specification of alum. tube & internal lacquer to be according to British Standard . (Analytical Certificate is required.)

packin

-Tubes to be packed in strong double corrugated carton.

-strong double corrugated cartons shrink warped, with nylon on pallet ,all necessary information & quantities to be printed on cartons & the palletes in outer sides

-The suppliers must be provide our company with not less than 100 un printed tube for quality control tests .

المرفقات :

-المخطط الهندسي لانيوب (٢٥ غم) المرقم (SDI-17)


+ مخطط العين السحرية المرقم (SDI-17B)

التاريخ: ٢٠٢٦/٣/٢٥

التوقيع: 

الاسم : خيرية جاسم محمد

المنصب : مسؤول الشعبة

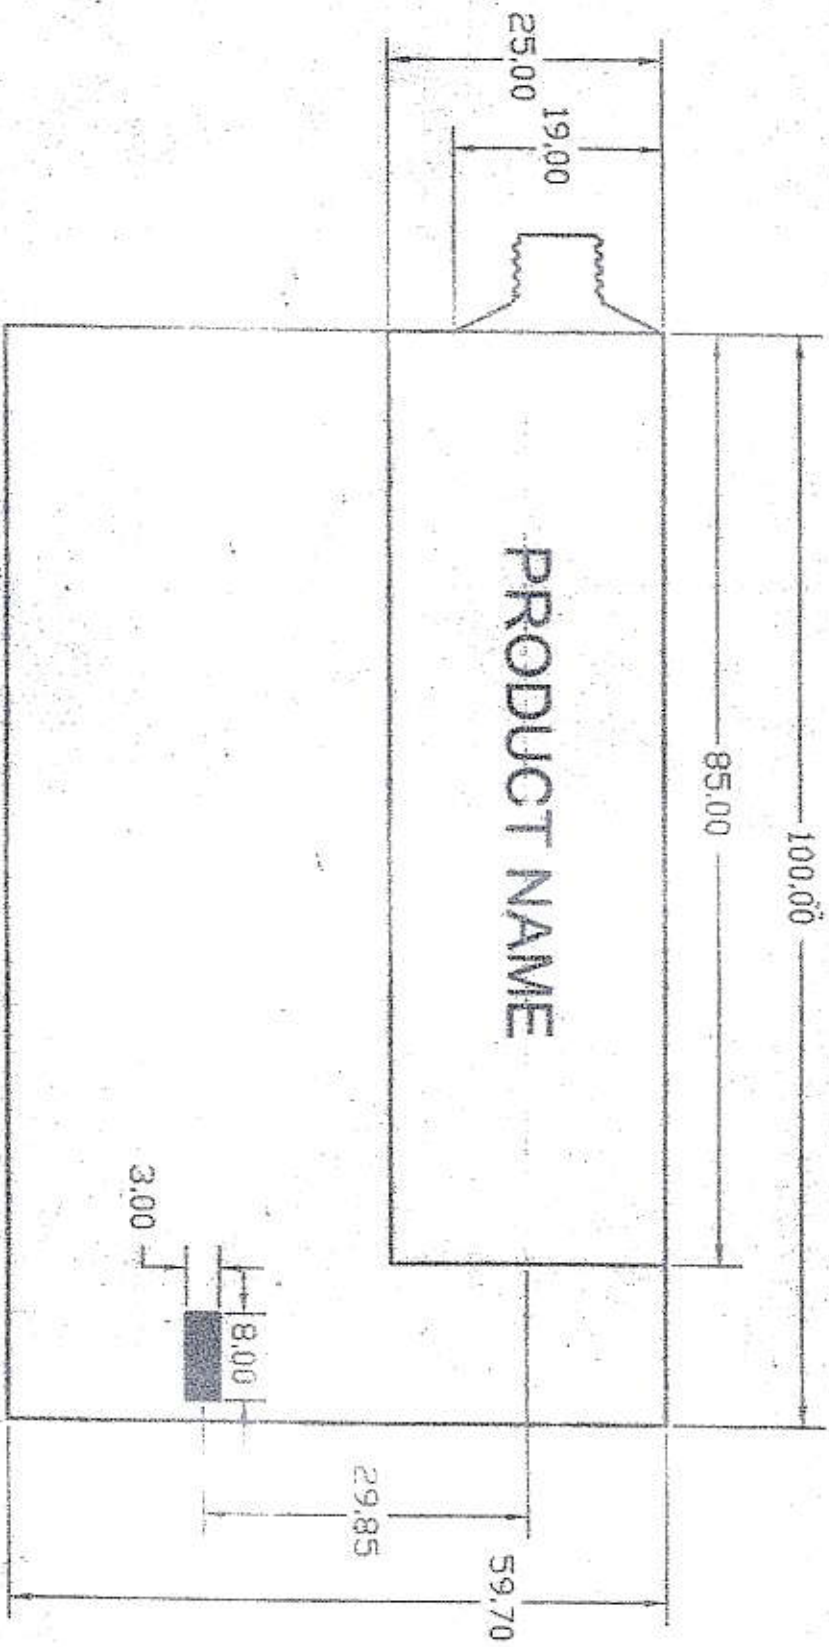

Aluminium tube \varnothing 19 mm, 108.8 mm Length

مخمسيف العلامه السعوديه كتر مع
مخمسيف مسطول الوجهه (المسكون)
وزن اوريه 180 درجه على محيط الاتوبه

9001-2008

ALL Dimensions : mm

DWG. NO.:

SDI-16B

Date:

16 - 2 - 2016

Drawn by :

ENG. Emad Hashem

Checked by:

Commission Spec.

Approved by:

D. Gerqral



القسم : التخطيط الشعبة : السيطرة على مواد التعبئة والتغليف العدد : التاريخ :

السيدة مدير التخطيط والمتابعة المحترم:

م/ مواصفات انابيب سعة ١٥ غم

1. Aluminum tubes 19 × 100 mm (15 g) cylindrical printed according designe of each tube.

internally lacquered for Skin Oint .& Creams (medical use) with orifice membrane & white cap with punctured thorn .

specifications

a.The tubes must contains gasket ring made of latex 7mm wide & should be fixed in side the tube approx 2mm (+1,-1 mm) from the tube end & should have a constant thickness of 0.02 – 0.025 mm.

b.The specification of alum. tube & internal lacquer to be according to British Standard (Analytical Certificate) is required.

packing

-Tubes to be packed in strong double corrugated carton.

-Strong double corrugated cartons shrink warped, with nylon on pallet ,all necessary information & quantities to be printed on cartons & the palletes in outer sides

-The suppliers must be provide our company with not less than 100 un printed tube for quality control tests .

المرفقات :


-المخطط الهندسي لانبوب (١٥ غم) المرقم (SDI- 16)

+ مخطط العين السحرية المرقم (SDI-16B)


التاريخ: ٢٠٢٦/٣/٢٥

التوقيع:



المنصب : مسؤول الشعبة الاسم : خيرية جاسم محمد

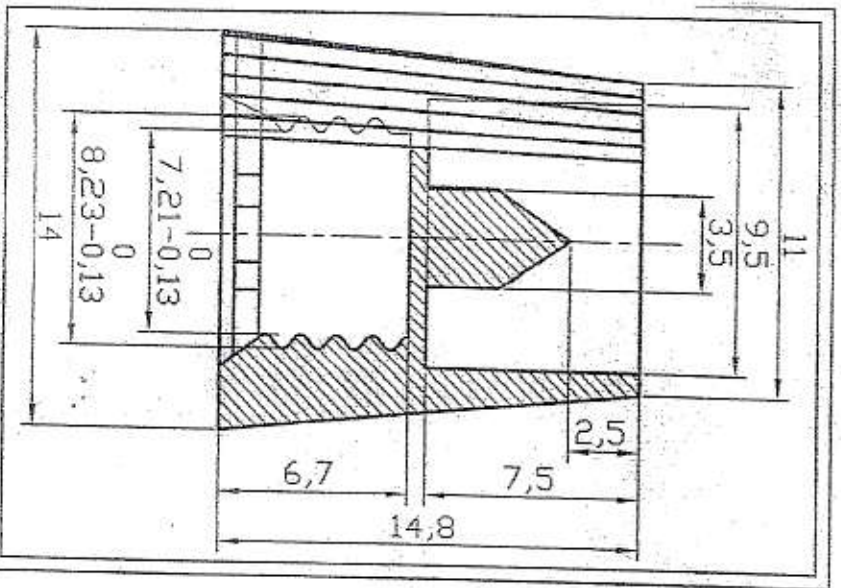

BP SDT: NOZZLE CAP NO. 90
 Mat.: PLASTIC
 Color: White

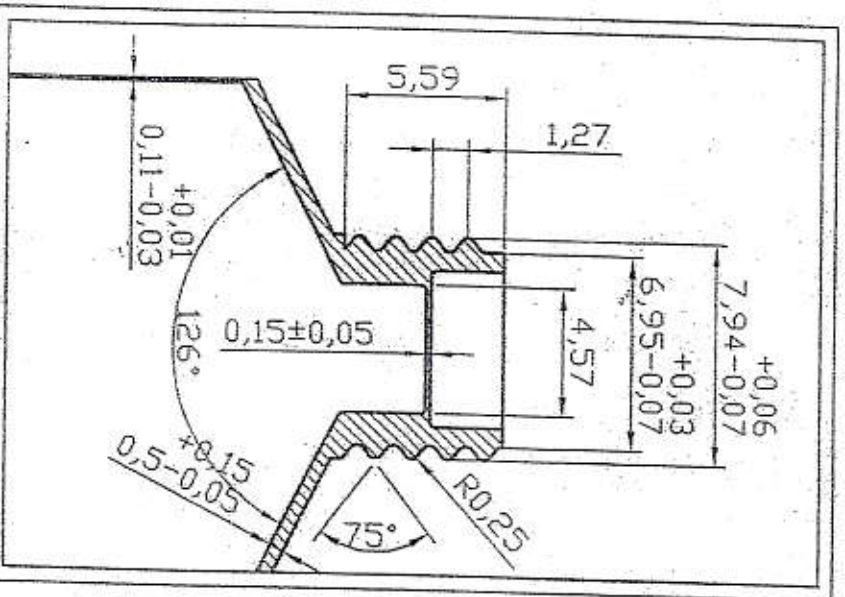

BP SDT: ALUMINIUM TUBE NOZZLE NO. 90
 Stepped membrane nozzle
 Thickness : (0.15± 0.05) mm

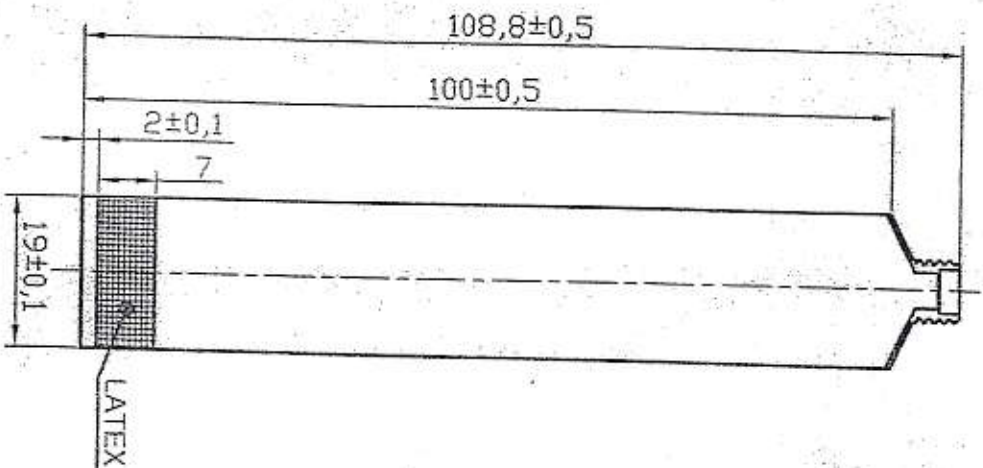

Aluminium tube Ø 19 mm, 108.8 Length
 Capacity : 15 gm
 Analytical according : PB

DWG. NO.: SDI-08
 Date: - 2016
 Drawn by :
 Checked by:
 Approved by:

ENG.Emad Hashem
 Commission Spec.
 D. General

Tubes shall be manufactured from Aluminium of not less than 99.7% purity.
 Continuity of internal coating limits (10 - 85) mA
 Thickness of LATEX : (0.02 - 0.025) mm

90001-2008

ALL Dimensions : mm