



الى: السادة الراغبين بالمشاركة

م/ اعلان مناقصة عامة
(تجهيز مواد تعبئة وتغليف)

1. على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال بـ (الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء) (٧ ساعات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
2. متطلبات التأهيل المطلوبة: (جميع الراغبين بالمشاركة من ذوي الخبرة والاختصاص (شركات / مكاتب).
3. بإمكان مقدمي العطاء المهنيين بشراء وثائق المناقصة مراجعة جهة التعاقد لغرض شرائها ورقياً وكما بحق لهم شراءها (وثائق المناقصة) الكترونياً عبر المنصة الالكترونية .
4. يلتزم المتنافس الفائز بالإحاطة بتقديم وصل (ورقي) او (الكتروني) صادر من ادارة المنصة الالكترونية بويده تسديده لاجور خدمات الاعلان والارشافة الالكترونية للمقد عبر المنصة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠ يوماً) من تاريخ التوقيع بالإحاطة وحسب التعليمات المتفق.
5. يتم تسليم العطاءات من قبل مقدمي العطاءات او مموليهم الرسميين وفق تحويل رسمي مصدق من كاتب عدل الى العنوان الاتي (مقر الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء - التشريعات - صندوق العطاءات) في الموعد المحدد في الجدول فضاء ولاتقبل العطاءات المتأخرة او التي يتم تقديمها بواسطة البريد الالكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في (مقر الشركة في سامراء) في الزمان والتاريخ (الساعة ١٢ ظهراً من يوم تاريخ الفتح المحدد) وإذا وافق يوم الفتح عطلة رسمية سيكون اليوم التالي هو اخر موعد لتقديم العطاءات.
6. يجب ان يتضمن العطاء الشروط والمستندات التالية:- (شهادة تأسيس الشركة او المكتب مصورة ملون، هوية غرفة التجارة نافذة ، اعمال معتمدة ، ويفضل حسابات ختامية لآخر سنتين مالية ، هوية تصنيف تجارية ، الهوية الضريبية لمقدم العطاء) .
7. التأمينات الأولية: مبلغ مقطوع وكما مبين في اثناء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سلتجة من مصرف عراقي معتمد ويكون نافذة لمدة ٩٠ يوماً من تاريخ الفتح وتستخدم لتكفل حسن الاداء بنسبة (٥%) من مبلغ العقد على شكل خطاب ضمان بعد التوقيع بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد.
8. كتابة عدم منافسة من الهيئة العامة للضرائب ويكون باسم الشركة او المكتب وليس باسم الشخص.
9. ثمن وثائق المناقصة واجور خدمات المنصة الالكترونية الموحدة للإعلانات والمنافسات وتكون غير قابل للرد .
10. على مقدم العطاء الذي سبق له الاشتراك في المناقصة المعاد اعلانها ان يقدم وصل الشراء السابق لها مع وثائق العطاء للمنافسة المعاد اعلانها وفي حالة تعديل السعر شراء هذه الوثائق لم تحصل مقدم العطاء الفرق بين السعرين في حالة زيادة السعر ويرافق مع عطفه الوصلين الاول والثاني وتزول ثمن الوثائق الى الخزينة العامة
11. فترة سريان العطاء (٩٠) يوم من تاريخ فتح العطاءات.
12. لشركتنا الحق في تصحيح أو تلافى أي نقص في الإعلان المنشور على ان يكون من خلال نفس الصحف ووسائل النشر المعتمدة في الاعلان .
13. الشركة غير ملزمة بقبول أو طرد العطاءات، ولها الحق في اختيار ما يناسبها ، ولها الحق ايضا تجزئة الإحاطة على اكثر من جهاز ولها الحق ايضا في الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة وبأسباب مبررة واعادة وصل شراء وثائق المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات.
14. في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية فانه سيتم استبعاد العطاء ، مما يتطلب مراعاة ذلك عند التقديم.
15. بحق لشركتنا شراء جزء او كامل الكمية والإحاطة على اكثر من جهاز.
16. الجهة التي لها صلاحية القول النهائي للمادة هي مستبرات شركتنا حصراً .
17. لاجور لمدير مقوض او (مخوله الرسمي) في اكثر من شركة او مكتب تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.
18. يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط والمواصفات الفنية والتجنية المطلوبة.
19. تدعو الشركة كافة المشاركين لحضور اجراءات فتح العطاءات في الساعة ثلثية عشر ظهراً من يوم (التوقيع المحدد).
20. كما تدعو شركتنا كافة المشاركين لحضور المؤتمر السنوي عقده في مقرها للإجابة على استفسارات المجهزين قبل اسبوع من موعد الفتح .
21. للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على مواصفات المادة المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمنافسة زبارة موقعاً الالكتروني (<https://sdi.industry.gov.iq>) وموقع وزارة الصناعة والمعادن الالكتروني (www.industry.gov.iq) .
22. على مقدم العطاء جلب براءة نمة تشمل تسديد اجور الكهرباء والهاتف الأرضي .
23. يلتزم المجهز بتقديم شهادة منشأ مصدقة من المفوضية العراقية في بلد المنشأ بالإضافة الى الفاتورة ووثائق التعبئة .
24. في حالة ورود عطاء غير جدي بما فيه تقديم تأمينات غير مصدقة يتم استبعاد مقدم العطاء وعدم التعامل معه لمدة (٦) ستة أشهر من الاشتراك بالمنافسات والطلبات المحلية .
25. في حال عدم التجهيز خلال المدة المحددة سيتم فرض غرامة بنسبة (٢٥ %) من مبلغ الاحاطة

رقم المناقصة العامة	تاريخ الفتح	المدة المطلوبة	الكلية التخمينية/ دينار	التأمينات الأولية/ دينار	سعر وصل شراء المناقصة دينار
SDI/2026/205	2026/8/3	اتانيب المنيوم للمراهم والكيرييمات قياس ١٥ غم اتانيب المنيوم للمراهم والكيرييمات قياس ٢٥ غم	497,000,000	10,934,000	497,000

المهندس الكيمياوي

محمد عبدالقادر مصطفى

المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٦/٧/١٥

Doc.No. P-09-F7

Issue :01

Data 1/5/2021



وزارة الصناعة والمعادن
الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية - سامراء
القسم التجاري-المشتريات المحلية

تاريخ الخلق 2026/8/3

المناقصة العامة 205/م/2026/SDI

ت	اسم المادة	التعبئة الفنية والتعبئة (بروفات مختلطة هندسية)	الكمية / الوحدة/ البوب	التكلفة التخمينية / الفرد / دينار	التكلفة التخمينية دينار	السعر التقني / دينار	تاريخ الطلب	فترة التجهيز
1	التيب المنيوم للمراهم والكريمات قياس ١٥ غم	حسب المواصفات الفنية	2,800,000	95	266,000,000	497,000,000 دينار	3/8/2026	30-80 يوم
2	التيب المنيوم للمراهم والكريمات قياس ٢٥ غم	والمختلطة الهندسية المرفقة	2,200,000	105	231,000,000			

- المنشأ يجب ان يكون من شركات متعددة وحسب المواصفة المذكورة وان تقدم الشهادة المطلوبة مع العرض الفني وبخلافه يتم اعتبار العرض غير مطابق للمواصفات.
- يجب ان لا يقل (Shelf life) للمادة المجهزة عن ثلثي عمرها المعتمد صناعيا.
- العرض يجب ان يكون مطابقاً للمواصفات الدستورية والتعبئة المطلوبة وسيتم اعتبار اي عرض لا يطابق المواصفات المطلوبة غير مطابق بغض النظر عن السعر.
- يتحمل المجهز المالك في التجهيز كافة الاضرار التي تلحق بشركتنا بسبب عدم تنفيذ البرنامج الانتاجي الخاص بالوكيلين التسويقيين (سوة بعقود الصحة).

المهندس الكيميائي

محمد عبدالقادر مصطفى

المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٦/٧/١٥



الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء

القسم : التخطيط الشعبة : السيطرة على مواد التعبئة والتغليف العدد : التاريخ : ٢٠٢٦/٣/١٠

السيدة مدير التخطيط والمتابعة المحترم:

م/ مواصفات انابيب سعة ١٥ غم

1. Aluminum tubes 19 × 100 mm (15 g) cylindrical printed according designe of each tube.

internally lacquered for Skin Oint .& Creams (medical use) with orifice membrane & white cap with punctured thorn .

specifications

a. The tubes must contains gasket ring made of latex 7mm wide & should be fixed in side the tube approx 2mm (+1,-1 mm) from the tube end & should have a constant thickness of 0.02 – 0.025 mm.

b. The specification of alum. tube & internal lacquer to be according to British Standard (Analytical Certificate) is required.

packing

- Tubes to be packed in strong double corrugated carton.

- Strong double corrugated cartons shrink warped, with nylon on pallet ,all necessary information & quantities to be printed on cartons & the palletes in outer sides

- The suppliers must be provide our company with not less than 100 un printed tube for quality control tests .



المرفقات :

- المخطط الهندسي لانبوب (١٥ غم) المرقم (SDI- 16)


+ مخطط العين السحرية المرقم (SDI-16B)

التوقيع : التاريخ : ٢٠٢٦/٦/١٠

المنصب : مسؤول الشعبة الاسم : خيرية جاسم محمد

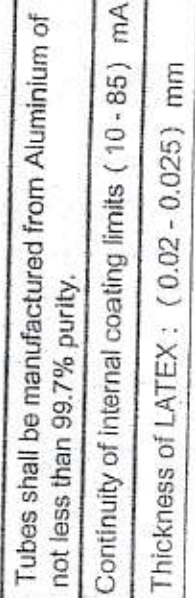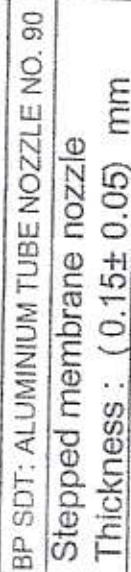

	Aluminium tube Ø 19 mm, 108.8 Length	DWG. NO.:	SDI-08
	Capacity : 15 gm	Date:	- 2016
	Analytical according : PB	Drawn by :	ENG. Emad Hashem
	ALL Dimensions : mm	Checked by:	Commission Spec.
9001-2008		Approved by:	D. General

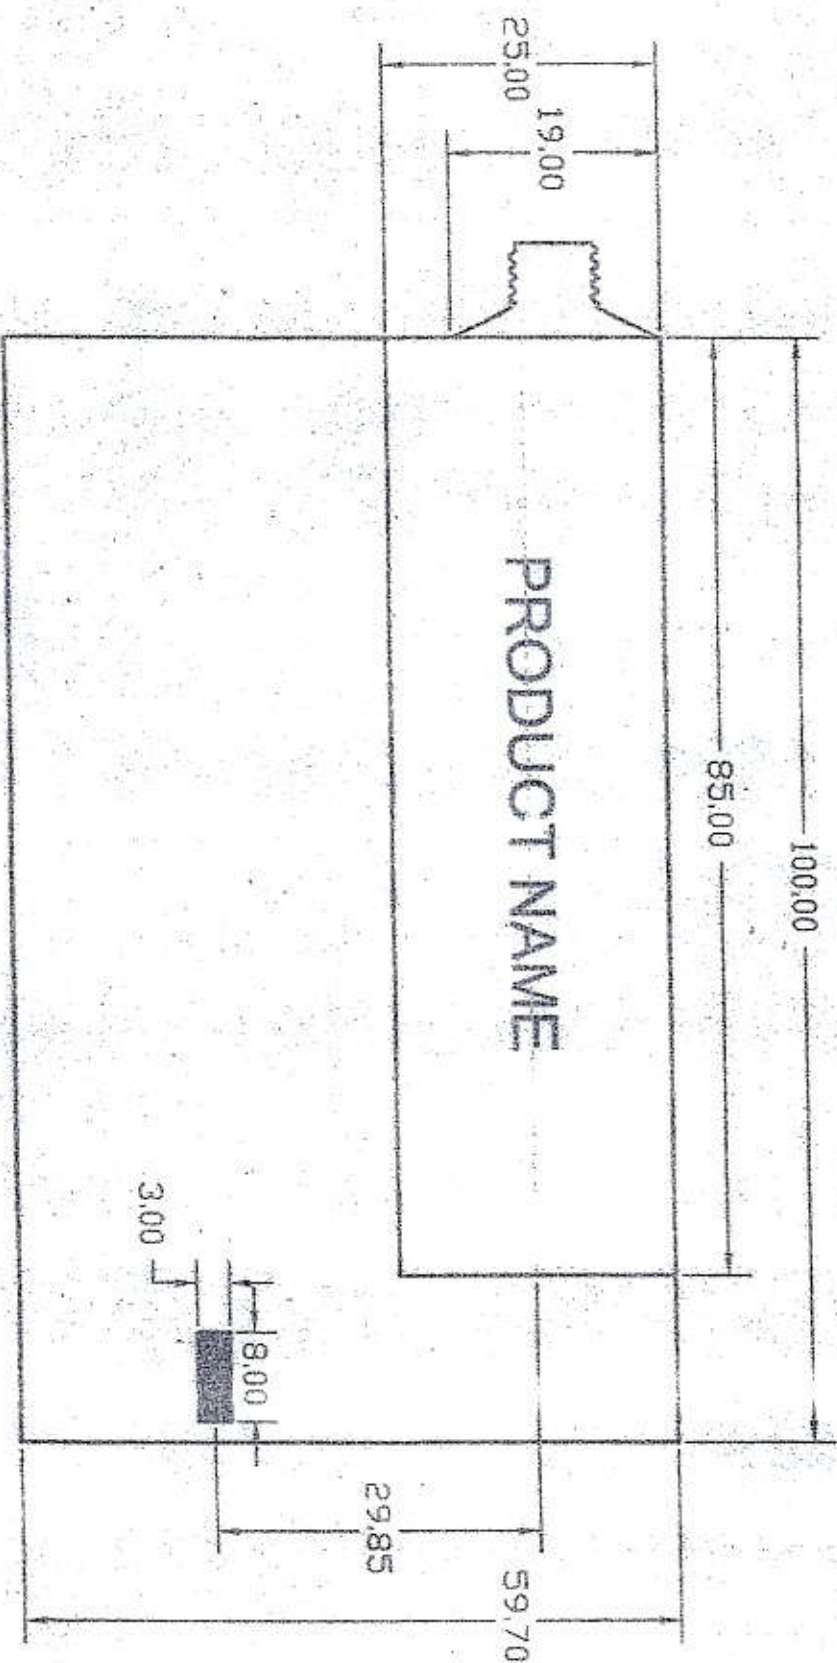

9001-2008

Al.L. Dimensions : mm

Aluminium tube $\varnothing$ 19 mm, 108.8 mm Length

مفتوح العلامة المسودة من الطر مع
مفتوح من الطول الراجعة (الطعون)
وزاوية 180 درجة على محيط الانزاحة

DWG. NO.:

SDI-165

Date:

16 - 2 - 2016

Drawn by :

ENG. Emad Hashem

Checked by :

Commission Spec.

Approved by :

D. General



السيد مدير التخطيط والمتابعة المحترم:

م/ مواصفات انابيب سعة ٢٥ غم

1. Aluminum tubes 22× 115 mm (25 g) cylindrical printed according designe of each tube.

internally lacquered for Skin Oint .& Creams (medical use) with orifice membrane & white cap with punctured thorn .

specifications

a. The tubes must contains gasket ring made of latex 7mm wide & should be fixed in side the tube approx 2mm (+1,-1 mm) from the tube end & should have a constant thickness of 0.02 – 0.025 mm.

b. The specification of alum. tube & internal lacquer to be according to British Standard . (Analytical Certificate is required. (

packin

- Tubes to be packed in strong double corrugated carton.

- strong double corrugated cartons shrink warped, with nylon on pallet ,all necessary information & quantities to be printed on cartons & the palletes in outer sides

- The suppliers must be provide our company with not less than 100 un printed tube for quality control tests .

المرفقات :

- المخطط الهندسي لانبوب (٢٥ غم) المرقم (SDI-17)

+ مخطط العين السحرية المرقم (SDI-17B)


٢٠٢٦/٦/١٠ التاريخ

التوقيع

الاسم : خيرية جاسم محمد

المنصب : مسؤول الشعبة

PRODUCT NAME

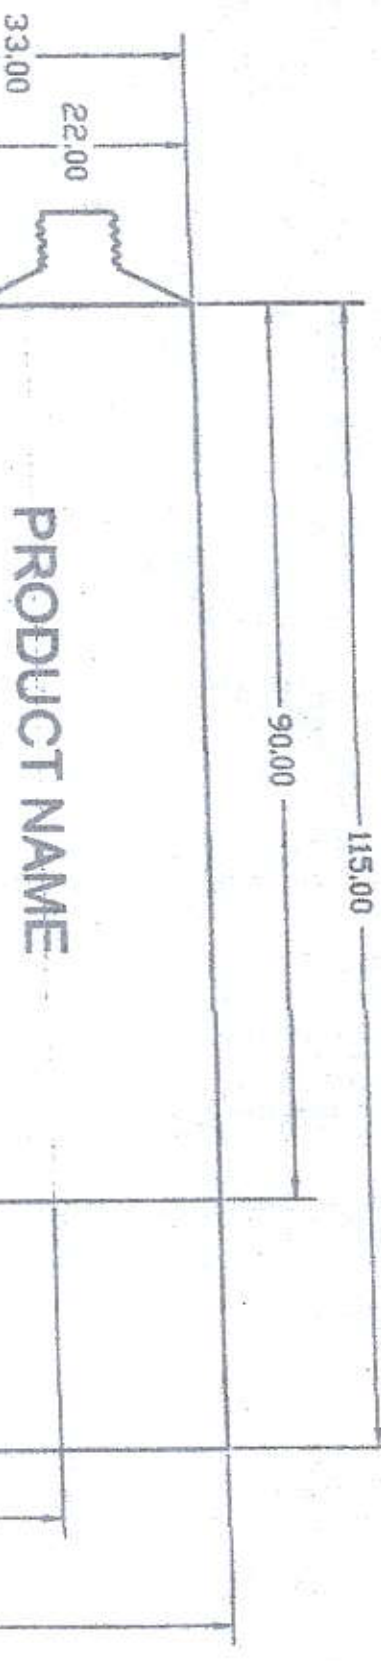

Aluminium tube Ø 22 mm, 125 mm Length

مقاسيكلب اللامعة السودة قطر مع
مقاسيكلب من قنبل الواجهة (المطون)
وزن اوزنة 180 درجة على محور الانوردة

DWG. NO.:

SDI-17B

Date:

16 - 2 - 2016

Drawn by :

ENG.Emad Hashem

Checked by:

Commission Spec.


Approved by:

D. General




ISO 9001-2008


ALL Dimensions : mm

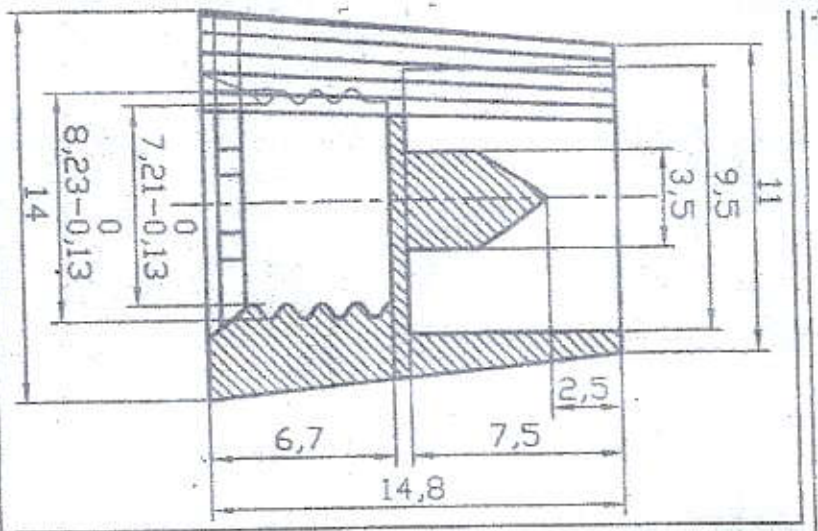

BP SDT: NOZZLE CAP NO. 90
Mat.: PLASTIC
Color: White

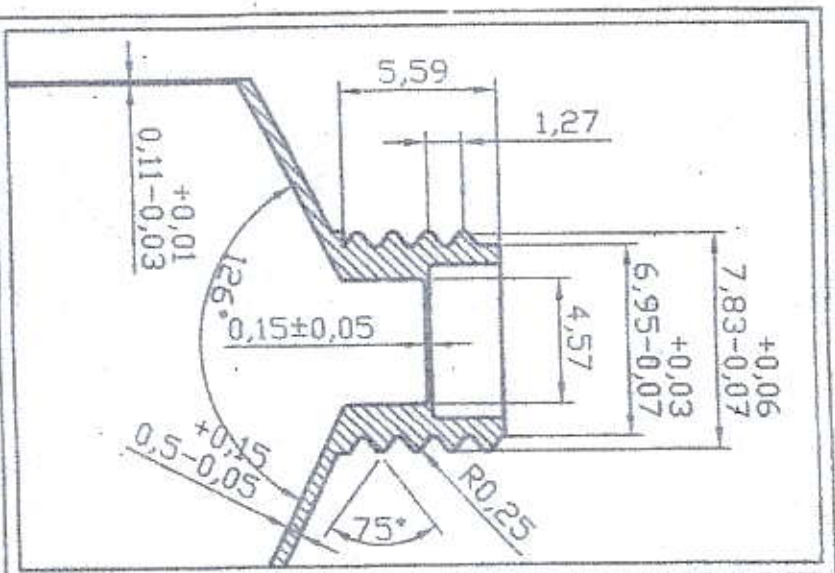

BP SDT: ALUMINIUM TUBE NOZZLE NO. 90
Stepped membrane nozzle
Thickness : (0.15±0.05) mm

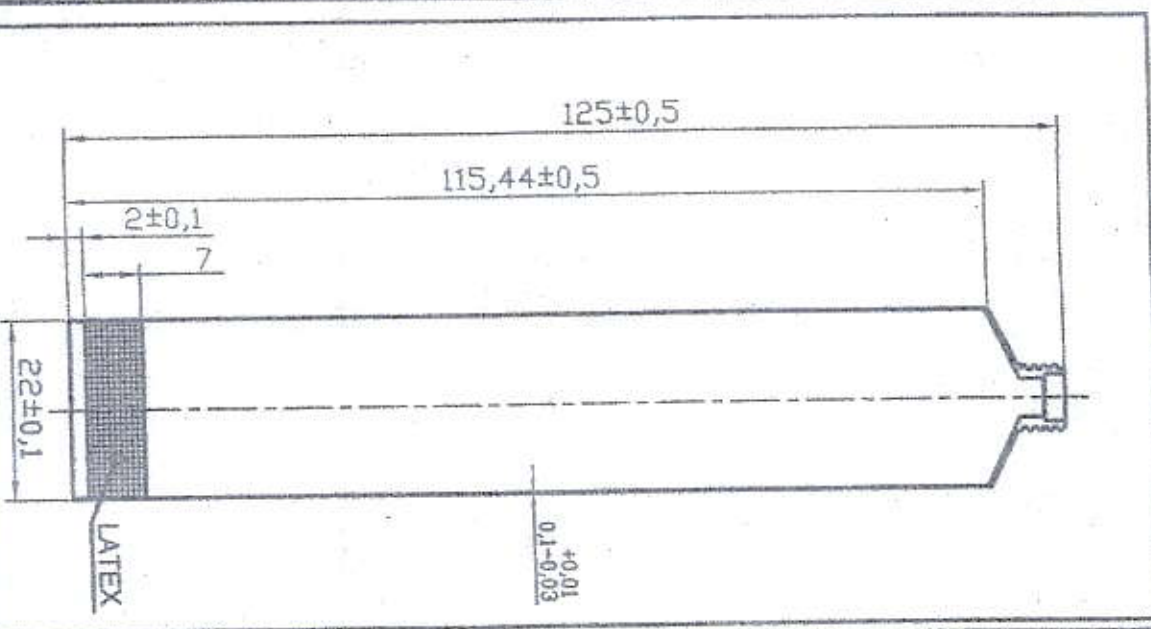

Tubes shall be manufactured from Aluminium of not less than 99.7% purity.
Continuity of internal coating limits (10 - 90) mA
Thickness of LATEX : (0.02 - 0.025) mm



Aluminium tube Ø 22 mm, 125 mm Length
Capacity : 25 gm
Analytical according BP

DWG. NO.:
Date:
Drawn by :
Checked by :

SDI-17
3 - 1 - 2016
ENG. Emad Hashem
Commission Spec.