



الى: السادة الراغبين بالمشاركة

١. يسر وزارة الصناعة والمعادن / الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء-القسم التجاري - المشتريات (المحلية) بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم مع ملاحظة ما يأتي:
٢. على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على مطومات اضافية الاتصال بـ (الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء) (٧ ساعات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
٣. متطلبات التأهيل المطلوبة: (جميع الراغبين بالمشاركة من ذوي الخبرة والاختصاص (شركات / مكاتب).
٤. بإمكان مقدمي العطاء المهتمين بشراء وثائق المناقصة وذلك بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في اعلاه وبعد دفع قيمة البيع للوثائق القياسية المذكورة في الجدول اناها.
٥. يتم تسليم العطاءات من قبل مقدمي العطاءات او مخلصيهم الرسميين وفق تحويل رسمي مصنف من كاتب عدل الى العنوان الآتي (مقر الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية /سامراء - التشريرات - صندوق العطاءات) في الموعد المحدد في الجدول اناها والعطاءات المتأخرة والتقديم بواسطة البريد الالكتروني مرفوضة، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او مخلصيهم الراغبين بالحضور في (مقر الشركة في سامراء) في الزمان والتاريخ (الساعة ١٢ ظهرا من يوم تاريخ القلق المحدد) واذا وافق يوم القلق عطلة رسمية سيكون اليوم التالي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعتبر يوم القلق.
٦. يجب ان يتضمن العطاء الشروط والمستمسكات التالية:- (شهادة تأسيس الشركة او المكتب مصورة ملون، هوية غرفة التجارة نافذة ، اعمال مماثلة ، حسابات ختامية لستين ماضيتين ، هوية تصنيف تجارية ، الهوية الضريبية لمقدم العطاء).
٧. التأمينات الأولية: مبلغ مقطوع وكما مبين في اناها على شكل خطاب ضمان او صك مصدق أو سفتجة من مصرف عراقي معتمد وتستبدل لتكون كفالة عدم اداء منسبة (٥%) من مبلغ العقد على شكل خطاب ضمان بعد التبليغ بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد.
٨. كتاب حسن المصادقة من الهيئة العامة للضرائب ويكون باسم الشركة او المكتب وليس باسم الشخص.
٩. ثمن وصل شراء وثائق المناقصة غير قابل للرد.
١٠. فترة سريان العطاء (٩٠) يوم من تاريخ خلق العطاءات.
١١. الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات، ولها الحق في اختيار ما يناسبها ، ولها الحق ايضا في الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة وبأسباب مبررة واعدة وصل شراء وثائق المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات.
١٢. في حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسية فانه سيتم استبعاد عطاءاتهم ، مما يتطلب مراعاة ذلك عند التقديم.
١٣. يكون تسديد المستحقات المالية عند ورود مستحقاتنا من وزارة الصحة والمستحضرات ذاتها وقيمة عقد الصحة والمبقي عند توفر السيولة النقدية.
١٤. فترة التجهيز كما مثبت في الوثيقة القياسية ، ويتم التقيد بها وبخلافه تحسب غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير وفقا للمعاهدة المذكورة في الوثيقة.
١٥. الجهة التي لها صلاحية القبول النهائي للمادة هي مختبرات شركتنا حصرا وفي حالة رفض المادة لشركتنا الحق في اتلافها كونها مطبوعة بشعار شركتنا.
١٦. لايجوز لمدير مفوض او (مخوله الرسمي) في اكثر من شركة او مكتب تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة.
١٧. يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر والاعلان.
١٨. يهمل اي عطاء غير مستوفي للشروط والمواصفات الفنية والتعينة المطلوبة.
١٩. تدعو الشركة كافة المشاركين لحضور اجراءات فتح العطاءات في الساعة الثامنة عشر ظهرا من يوم (القلق المحدد).
٢٠. كما تدعو شركتنا كافة المشاركين لحضور المؤتمر المنوي عقده في مقرها للاجابة على استفسارات المجيزين قبل اسبوع من موعد القلق للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على مواصفات المادة المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة زيارة موقعنا الالكتروني (<https://sdi.industry.gov.iq>) وموقع وزارة الصناعة والمعادن الالكتروني (www.industry.gov.iq)

رقم المناقصة	تاريخ القلق	المادة المطلوبة	الكلفة التخمينية/ دينار	التأمينات الأولية/ دينار	سعر وصل شراء المناقصة د.ع
٢٠٢٤/SDI/٢٠٢	٢٠٢٤/٨/١٢	انابيب المعنوم مراهم وكريمات بالغابسات (٢٥٠١٥) غم	٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٣٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠

المهندس

محمد عبدالقادر مصطفى

المخول بصلاحيات المدير العام

٢٠٢٤/٧/٢٤





وزارة الصناعة والمعادن

الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية - سامراء

القسم التجاري

المنافسة العامة : ٢٠٢٢/م/SDI/٢٠٢٤

تاريخ الخلق : ٢٠٢٤/٨/١٢

الاسم المطلوب	الكمية / انبوية	الابعاد والمواصفات
انابيب المنيوم مراهم وكريمات (١٥ غم)	2,500,000	حسب المخططات والمواصفات المرفقة
انابيب المنيوم مراهم وكريمات (٢٥ غم)	2,500,000	

- ١- المنشأ يجب ان يكون من شركات معتمدة وحسب المواصفة المذكورة.
- ٢- فترة التجهيز : حسب ما مثبت بالوثيقة القياسية (٤٠ يوم الى ٨٠ يوم)
- ٣- العرض يجب ان يكون مطابقاً للمواصفات الدستورية المطلوبة وسيتم اعتبار اي عرض لا يطابق المواصفات المطلوبة غير مطابق بغض النظر عن السعر.





القسم : التخطيط الشعبة : السيطرة على مواد التعبئة والتغليف العدد : التاريخ : 2024/5/19

السيدة مدير التخطيط المحترم:

م/ مواصفات انابيب سعة 15 غم

1. Aluminum tubes 19 × 100 mm (15 g) cylindrical printed according designe of each tube.

internally lacquered for Skin Oint .& Creams (medical use) with orifice membrane & white cap with punctured thorn .

specifications

a. The tubes must contains gasket ring made of latex 7mm wide & should be fixed in side the tube approx 2mm (+1,-1 mm) from the tube end & should have a constant thickness of 0.02 – 0.025 mm.

b. The specification of alum. tube & internal lacquer to be according to British Standard (Analytical Certificate) is required.

packing

- Tubes to be packed in strong double corrugated carton.

- Strong double corrugated cartons shrink warped, with nylon on pallet ,all necessary information & quantities to be printed on cartons & the palletes in outer sides

- The suppliers must be provide our company with not less than 100 un printed tube for quality control tests .

المرفقات :

-المخطط الهندسي لانبوب (15 غم) المرقم (SDI- 08)

+ مخطط العين السحرية المرقم (SDI-16B)



المنصب : مسؤول الشعبة الاسم : خيرية جاسم محمد التوقيع : التاريخ : 2024/5/19



السيدة مديرة التخطيط والمتابعة المحترمة :

م/ مواصفات انابيب سعة 25غم

1. Aluminum tubes 22× 115 mm (25 g) cylindrical printed according designe of each tube.

internally lacquered for Skin Oint .& Creams (medical use) with orifice membrane & white cap with punctured thorn .

specifications

a. The tubes must contains gasket ring made of latex 7mm wide & should be fixed in side the tube approx 2mm (+1,-1 mm) from the tube end & should have a constant thickness of 0.02 – 0.025 mm.

b. The specification of alum. tube & internal lacquer to be according to British Standard . (Analytical Certificate is required. (

packin

- Tubes to be packed in strong double corrugated carton.

- strong double corrugated cartons shrink warped, with nylon on pallet , all necessary information & quantities to be printed on cartons & the palletes in outer sides

- The suppliers must be provide our company with not less than 100 un printed tube for quality control tests .

المرفقات :

- المخطط الهندسي لانبوب (25 غم) المرقم (SDI-17)

+ مخطط العين السحرية المرقم (SDI-17B)




التاريخ: 2024/5/19

التوقيع: 

الاسم: خيرية جاسم محمد

المنصب: مسؤول الشعبة



Aluminium tube Ø 22 mm, 125 mm Length

متصنف العلامة المسوداء تتناظر مع
متصنف من تطيل الواجهة (المطون)
وزن اوزونة 180 درجة على محيط الانبوبية

ISO 9001-2008

ALL Dimensions : mm

DWG. NO.:

SDI-17B

Date:

16 - 2 - 2016

Drawn by :


ENG.Emad Hashem


Checked by:

Commission Spec.


Approved by:

D. General






BP SDT: NOZZLE CAP NO. 90
 Mat.: PLASTIC
 Color: White




BP SDT: ALUMINIUM TUBE NOZZLE NO. 90
 Stepped membrane nozzle
 Thickness : (0.15±0.05) mm



Aluminium tube Ø 22 mm, 125 mm Length	DWG. NO.:	SDI-17
Capacity : 25 gm	Date:	3 - 1 - 2016
Analytical according BP	Drawn by :	ENG. Emad Hashem
	Checked by :	Commission Shar

Tubes shall be manufactured from Aluminium of not less than 99.7% purity.
 Continuity of internal coating limits (10 - 90) mA






5070
 قسم الشؤون التجارية
 29 85




Aluminium tube Ø 19 mm, 108.8 mm Length
 منتج من العلامة المسوداء تحت إشراف مع
 متخصص من تظيل الواجهة (الطون)
 وزير اورية 180 درجة على محيط الانوية

9001-2008 ALL Dimensions : mm


DWG. NO.:	SDI-16B
Date:	16 - 2 - 2016
Drawn by :	ENG.Emad Hashem
Checked by:	Commission Spec.
Approved by:	D. General

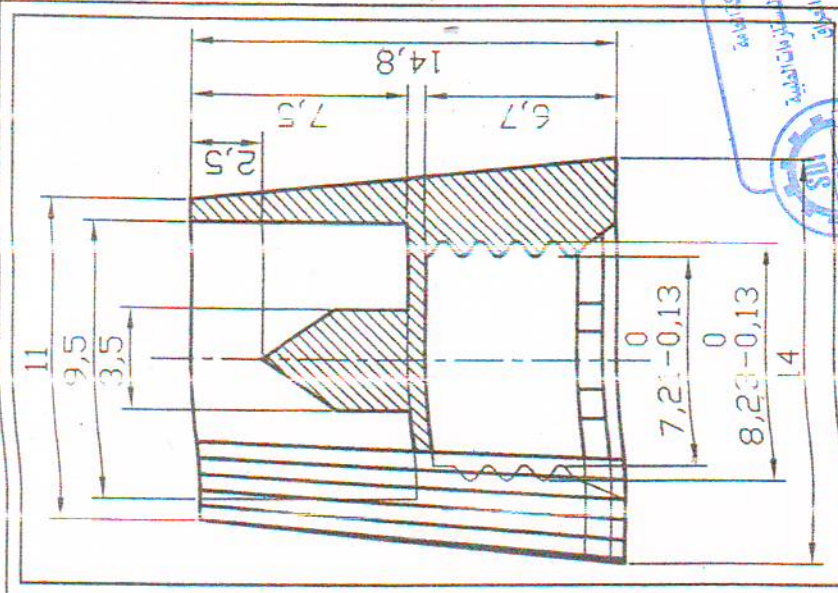


BP SDT: NOZZLE CAP NO. 90
 Mat: PLASTIC
 Color: White

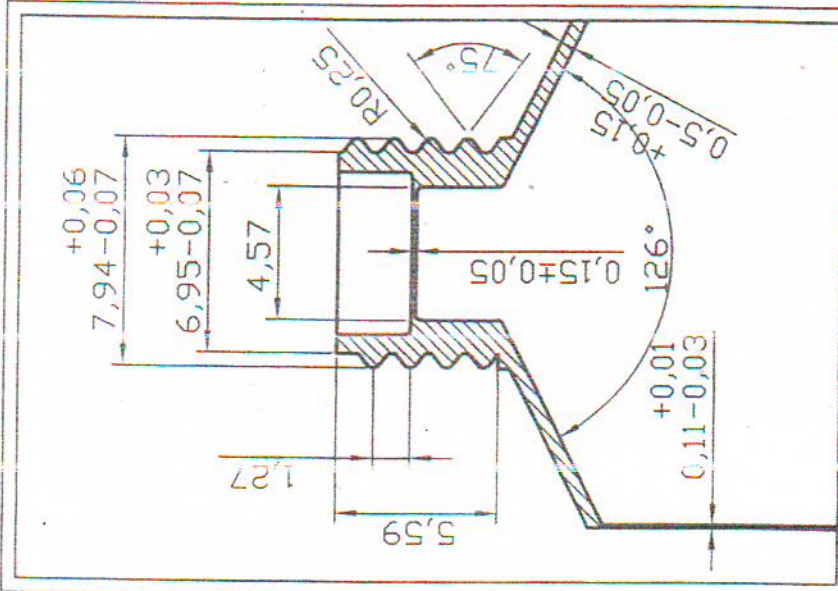


BP SDT: ALUMINIUM TUBE NOZZLE NO. 90
 Stepped membrane nozzle
 Thickness : (0.15± 0.05) mm



Tubes shall be manufacture from Aluminium of not less than 99.7% purity.
 Continuity of internal coating limits (10 - 85) mA
 Thickness of LATEX : (0.02 - 0.025) mm

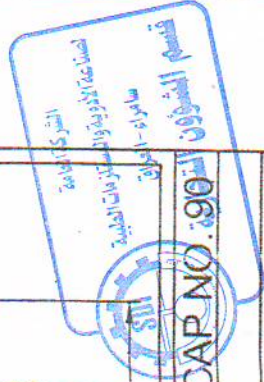

	Aluminium tube Ø 19 mm, 108.8 Length	DWG. NO.:	SDI-08
	Capacity : 15 grn	Date:	- 2016
Analytical according : PB	Drawn by :	ENG.Emad Hashem	
ALL Dimensions : mm	Checked by:	Commission Spec.	
	9001-2008	Approved by:	D. Genji